たいら鶏卵事業協同組合　御中

2017年8月4日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 水(飲料水)
受付番号: F2803006
受付日: 2017年8月3日
測定日: 2017年8月3日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I(ヨウ素131)	^{134}Cs(セシウム134)＋^{137}Cs(セシウム137)	新規制値[1]
飲料水	新規制値以下	新規制値以下	^{131}I(ヨウ素131) 300Bq/kg以下および ^{134}Cs(セシウム134)と ^{137}Cs(セシウム137)の 合計が10Bq/kg以下

[1] 新規制値は右記のものを記載:飲料水
＊実表中の^{131}I の数値は鉛に対する機械の性能による誤判断数値と思われる。

検査担当者:　佐藤　友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：水__たいら鶏卵事業協同組合
産地	：
検体番号	：Ｆ２８０３００６
依頼者	：ＰＰＱＣ（たいら鶏卵事業協同組合）
分類	：水
コメント	：
供試量	：1.058 kg
測定試料重量	：1.058 kg
測定試料タイプ	：マリネリKM301(水)

【 測定情報 】

データID	：S0120170803150211-02
測定日時	：2017/08/03 (木) 15:02:11
測定時間	：85 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり (BG測定日時：2017/08/03 (木) 11:54:04)
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】
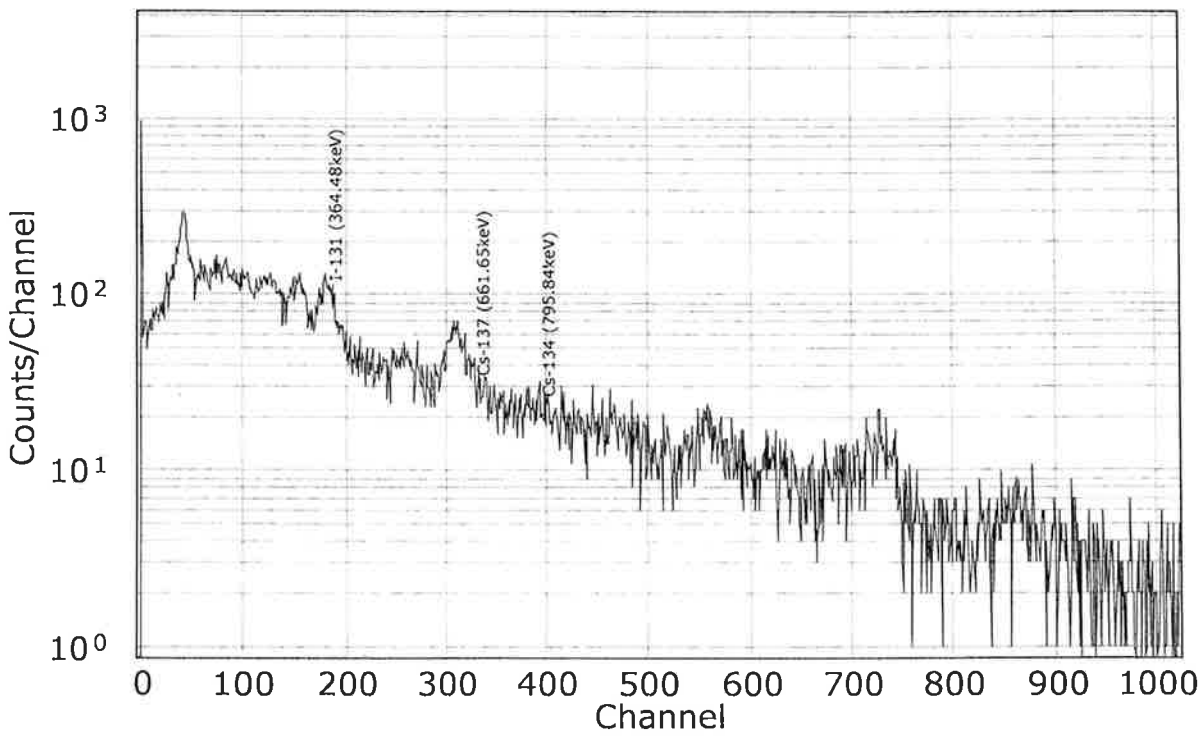
No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	検出	I-131	364.48	9.85E+02 ± 1.54E+02	7.57E+00 ± 2.19E+00	1.83E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	4.74E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	5.06E+00
		Cs合計 (Cs-134,Cs-137不検出)			N.D.	(9.80E+00) (誤差は３σ)